ATUALIZAÇÃO DE PRODUTO

stryker®

São Paulo, 9 de maio de 2008

Sistemas para Joelho Scorpio® e Scorpio NRG®
Bloco e Guia de Corte Tamanho 3

A Stryker Orthopaedics percebeu que há um potencial para Interferência do Pino de fixação e do Bloco de Corte nº 3 (Universal Notch Preparation Guide size 3, ref. 7650-3363).
Se o cirurgião tentar agressivamente a progressão do bloco de corte, com a interferência do pino, este pode entortar e dificultar ou impedir a remoção do Guia de Corte.
Nessa situação pode ocorrer uma maior demora da duração da cirurgia, lesão óssea e remotamente fratura da porção distal do fêmur.
A Stryker recomenda que as instruções seguintes sejam utilizadas ao usar o Guia de Corte Tamanho 3:

- Pinos usados com o Bloco de Corte tamanho 3 devem ser colocados através da chanfradura anterior para minimizar a chance de atingir o Bloco de Corte.
- Não coloque pinos pela borda anterior.
- Pinças de campo também podem ser usadas para estabilidade adicional se necessário, nos orifícios indicados no plano distal.

Correto

Incorreto

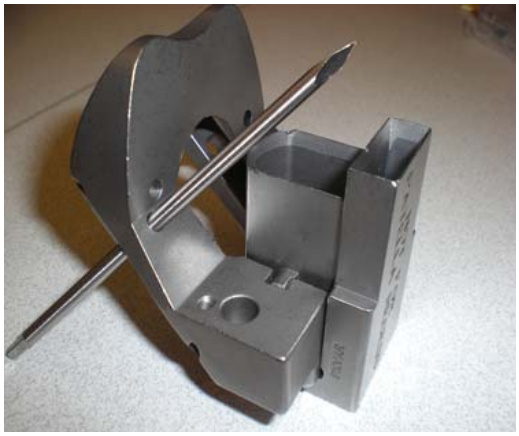

Através da chanfradura anterior
CORRETO

Através da flange anterior
INCORRETO

Por favor, contate (11) 5189-2500, Dr.Sergio Alcântara Madeira, se você tiver qualquer pergunta ou necessitar de informação adicional.