



**Aviso de Orientação em Campo**  
**Divisão de Diagnóstico Molecular da Abbott**

**Produto:** RealTime HIV-1 Calibrator Kit

**Número de Lista:** 02G31-70

**Número de Lote:** 530451

**Identificador de Dispositivo Único:**

(01)00884999001497(10)530451(17)231103(240)2G31-70

14 de fevereiro de 2023

Prezado(a) Cliente Abbott,

Este comunicado contém informações importantes relacionadas ao kit de calibradores RealTime HIV-1, Número de Lista 02G31-70, Número de Lote 530451. Leia as informações atentamente.

**Explicação**

A Abbott determinou que o prazo de validade impresso na ficha do kit de calibradores RealTime HIV-1, Número de Lista 02G31-70, Número de Lote 530451, está incorreto. O prazo de validade incorreto é **2023-11-23** (Figura de Referência 1 na página seguinte), e essa data incorreta foi observada na ficha de calibradores inserida no produto que você recebeu. O prazo de validade correto é **2023-11-03**, e essa data correta pode ser verificada na embalagem do kit na parte externa (Figura de Referência 2 na página seguinte) do produto recebido. Favor consultar a Figura 1 para ver a rotulagem incorreta e a Figura 2, para a rotulagem correta.

**Potencial Impacto**

Existe um potencial impacto se os kits forem utilizados entre 4 de novembro de 2023 e 23 de novembro de 2023.

**Medidas Necessárias**

Descarte as fichas de calibradores recebidas com o seu kit de calibradores RealTime HIV-1, Número de Lista 02G31-70, Número de Lote 530451, que estejam em sua posse no momento.

Guarde a ficha de calibradores substituta incluída neste comunicado.

Preencha e devolva o formulário de Resposta do Cliente em anexo.


Revise estas informações juntamente com o pessoal de laboratório e guarde este comunicado para referência futura. Caso tenha dúvidas relacionadas a este comunicado, entre em contato com o seu representante local da Abbott. Pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes que isso possa ter causado ao seu laboratório.

Atenciosamente

Ray Bastian  
Vice-Presidente Divisional, Garantia de Qualidade  
Divisão de Diagnóstico Molecular da Abbott

**Aviso de Orientação em Campo**  
**Divisão de Diagnóstico Molecular da Abbott**  
**Produto: RealTime HIV-1 Calibrator Kit**  
**Número de Lista: 02G31-70**  
**Número de Lote: 530451**  
**Identificador de Dispositivo Único:**  
 (01)00884999001497(10)530451(17)231103(240)2G31-70

**Figura 1: Ficha de calibradores original - prazo de validade incorreto**

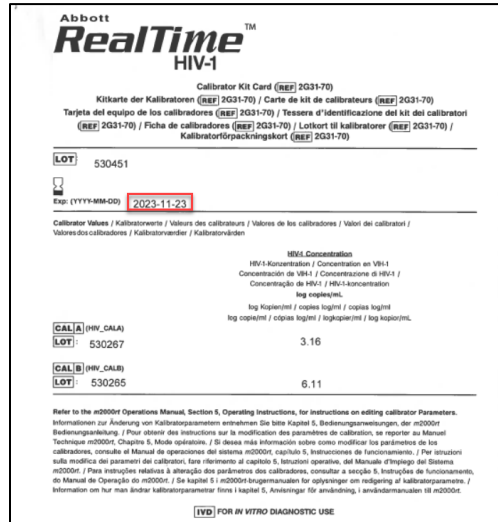

**Figura 2: Embalagem externa do kit - prazo de validade correto**

